5. Свидетельство о приемке

Калибр изготовлен и принят в соответствии с указанными техническими данными и признан годным к эксплуатации.

Дата первичной поверки _____
(дата)

М.П.

Поверку произвел _____
(подпись)

_____
(расшифровка)

Гарантийный срок эксплуатации при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения 1 год со дня продажи.

Претензии по качеству направлять по адресу изготовителя.

Предприятие-изготовитель:
ООО «ПКФ «ЭТНА»
187032, Ленинградская обл., Тосненский район, поселок Тельмана, дом 2 Б, помещение 1С
Тел: (812) 602-92-42, 8-800-511-48-08
etna-spb@mail.ru
https://www.etna-instrument.ru

ООО «ПКФ «ЭТНА»

ЭТНА
инструментальная компания

Калибр для измерения зазоров и перепадов
0,5 – 8,0 мм
(S-05-80)
Паспорт

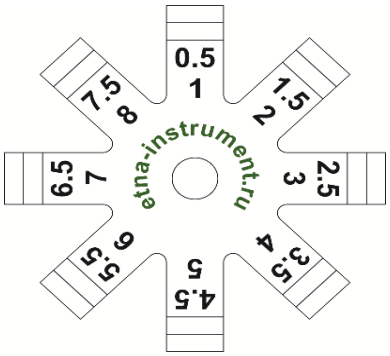

Россия

5. Свидетельство о приемке

Калибр изготовлен и принят в соответствии с указанными техническими данными и признан годным к эксплуатации.

Дата первичной поверки _____
(дата)

М.П.

Поверку произвел _____
(подпись)

_____
(расшифровка)

Гарантийный срок эксплуатации при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения 1 год со дня продажи.

Претензии по качеству направлять по адресу изготовителя.

Предприятие-изготовитель:
ООО «ПКФ «ЭТНА»
187032, Ленинградская обл., Тосненский район, поселок Тельмана, дом 2 Б, помещение 1С
Тел: (812) 602-92-42, 8-800-511-48-08
etna-spb@mail.ru
https://www.etna-instrument.ru

ООО «ПКФ «ЭТНА»

ЭТНА
инструментальная компания

Калибр для измерения зазоров и перепадов
0,5 – 8,0 мм
(S-05-80)
Паспорт

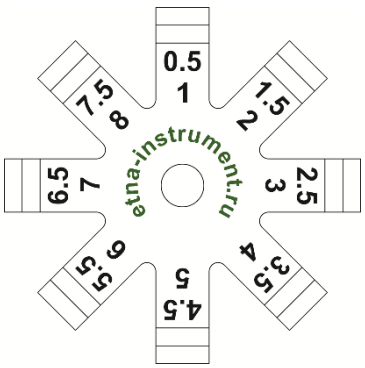

Россия

Таблица 1

Толщина Калибра, мм	Допускаемые отклонения, мм	
	новых	изношенных
0,5 / 1,0	± 0,1	-0,20
1,5 / 2,0	± 0,1	-0,20
2,5 / 3,0	± 0,1	-0,20
3,5 / 4,0	± 0,1	-0,20
4,5 / 5,0	± 0,1	-0,20
5,5 / 6,0	± 0,1	-0,20
6,5 / 7,0	± 0,1	-0,20
7,5 / 8,0	± 0,1	-0,20

1. Назначение

Калибр предназначен для измерения зазоров

2. Технические данные

Общий вид Калибра представлен на рисунке 1.

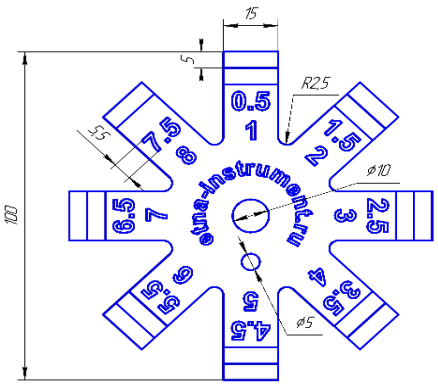

Рис.1

Мерительные поверхности располагаются в Калибре на «лепестках».

Номинальные размеры Калибра, мм:

диаметр (D) – 100,

толщина (S) – 8.

Рабочие толщины «лепестков» Калибра согласно табл. 1

На рабочих поверхностях Калибра не должно быть дефектов,

портящих внешний вид и влияющих на эксплуатационные свойства.

Калибры изготавливаются из материала ПВХ Simona CAW 8 мм (Темно-серый)

3. Комплектность

В комплект поставки входят:

Калибр _____ шт.

Паспорт **1** шт.

4. Методы контроля

Контроль Калибра производить методами и средствами, указанными в п/п 3.2, 3.4 МИ 1893.

Таблица 1

Толщина Калибра, мм	Допускаемые отклонения, мм	
	новых	изношенных
0,5 / 1,0	± 0,1	-0,20
1,5 / 2,0	± 0,1	-0,20
2,5 / 3,0	± 0,1	-0,20
3,5 / 4,0	± 0,1	-0,20
4,5 / 5,0	± 0,1	-0,20
5,5 / 6,0	± 0,1	-0,20
6,5 / 7,0	± 0,1	-0,20
7,5 / 8,0	± 0,1	-0,20

1. Назначение

Калибр предназначен для измерения зазоров

2. Технические данные

Общий вид Калибра представлен на рисунке 1.

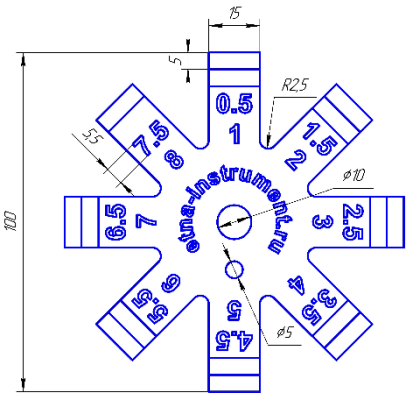

Рис.1

Мерительные поверхности располагаются в Калибре на «лепестках».

Номинальные размеры Калибра, мм:

диаметр (D) – 100,

толщина (S) – 8.

Рабочие толщины «лепестков» Калибра согласно табл. 1

На рабочих поверхностях Калибра не должно быть дефектов,

портящих внешний вид и влияющих на эксплуатационные свойства.

Калибры изготавливаются из материала ПВХ Simona CAW 8 мм (Темно-серый)

3. Комплектность

В комплект поставки входят:

Калибр _____ шт.

Паспорт **1** шт.

4. Методы контроля

Контроль Калибра производить методами и средствами, указанными в п/п 3.2, 3.4 МИ 1893.