

## 9. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ И УПАКОВКЕ

9.1 Штангенглубиномер подвергнут консервации в соответствии требованиям ГОСТ 9014-78.

Срок защиты без переконсервации – 2 года.

9.2 Штангенглубиномер упакован предприятием-изготовителем согласно требованиям ГОСТ 13762-86.

## 10. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ И ОТДЕЛЕ ПРОДАЖ

### 10.1 Изготовитель:

Фирма «Etalon», Китай

### 10.2 Отдел продаж:

АО ТД «Калиброн»

111524, Россия, г. Москва, ул. Электродная, д. 2, стр. 7, эт. 5, пом. XII, ком. 14

Тел./ Факс: +7 (495) 380-11-06

E-mail: [info@tdkalibron.ru](mailto:info@tdkalibron.ru)

## 11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Штангенглубиномер соответствует требованиям технической документации фирмы-изготовителя и признан годным к эксплуатации.

Заводской № \_\_\_\_\_

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Подписи лиц, ответственных за приемку \_\_\_\_\_

М.П.



Фирма «Etalon»

АО Торговый дом «Калиброн»  
111524, Москва, ул. Электродная, д.2, стр.7, эт. 5,  
пом. XII, ком. 14

## ПАСПОРТ

Штангенглубиномер фирмы «Etalon»  
с цифровым отсчетным устройством  
стандартная штанга

Диапазон измерений, мм:

☐ 0-250

Шаг дискретности, мм: 0,01

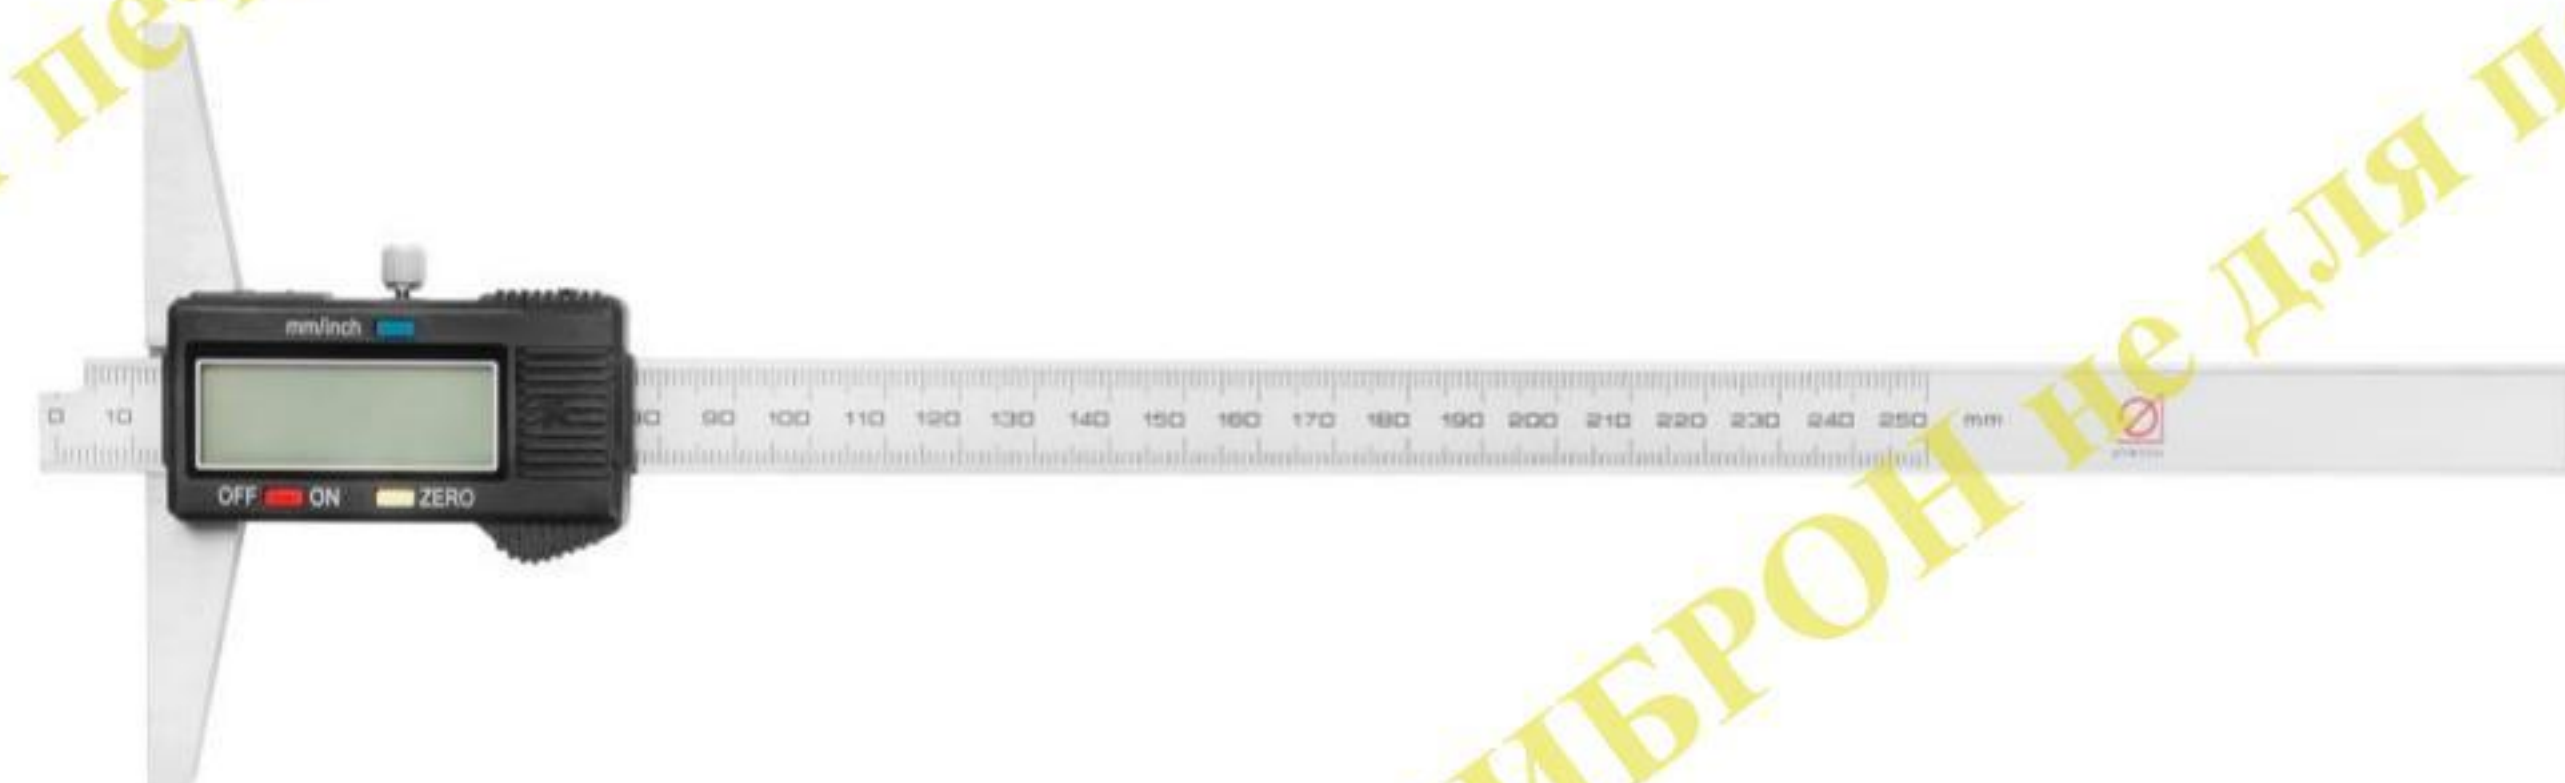


Рисунок 1

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Штангенглубиномер фирмы «Etalon» с цифровым отсчетным устройством (Рис. 1) предназначен для измерения глубины элементов деталей, состоит из рамки и штанги с измерительной поверхностью.

## 2. НОРМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура воздуха: от 15 до 25 °С

Относительная влажность воздуха: не более 80 %

## 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1 Таблица 1. Основные технические характеристики

| Диапазон измерений, мм | Шаг дискретности, мм, | Длина измерительной поверхности рамки, мм, не менее |
|------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| от 0 до 250            | 0,01                  | 100                                                 |

3.2 Таблица 2. Пределы допускаемой абсолютной погрешности штангенглубиномеров при температуре окружающей среды ( $20 \pm 5$ ) °С

| Измеряемая глубина, мм | Погрешность, мм |
|------------------------|-----------------|
| 0-250                  | $\pm 0,04$      |

Отклонение от плоскостности измерительной поверхности штанги не более 0,004 мм.

Отклонение от плоскостности измерительной поверхности рамки не более 0,006 мм.

## 4. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

4.1 Штангенглубиномер

4.2 Футляр

4.3 Паспорт

## 5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание травматизма необходимо не допускать измерений при движении режущего инструмента и при движении измеряемой детали.

## 6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1 Протереть чистой салфеткой, смоченной в нефрасе, измерительные поверхности основания и штанги, выдержать инструмент на рабочем месте не менее 3 ч.

6.2 Ослабить фиксирующий винт и подвигать рамку, чтобы проверить правильность работы экрана дисплея и кнопок.

6.3 В процессе работы со штангенглубиномером не допускать:

- грубых ударов или падений во избежание изгиба штанги и других поверхностей;
- царапин на измерительных поверхностях.

6.4 Не измерять детали на ходу станка.

6.5 После окончания работы штангенглубиномер протереть чистой салфеткой, смоченной в нефрасе, затем насухо - чистой салфеткой и уложить в футляр.

6.6 Воздух в помещении не должен содержать примесей и агрессивных паров и газов.

## 7. ПОРЯДОК РАБОТЫ

7.1 Для включения/выключения штангенглубиномера нажмите кнопку (OFF/ON), если дисплей не загорается нужно заменить батарейку.

7.2 Для того, чтобы выбрать необходимую систему измерений мм/дюйм нажмите кнопку мм/ins. Для установки нуля нажмите кнопку (ZERO).

7.3 При измерении глубины детали, глубиномер необходимо устанавливать перпендикулярно дну детали.

## 8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие штангенглубиномера требованиям технической документации фирмы-изготовителя при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

8.2 Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи штангенглубиномера.

8.3 Гарантийный срок хранения 24 месяца.

8.4 Средний срок службы не менее 5 лет.