

Эталон чувствительности канавочный «Спрут» модификация 12 ПАСПОРТ

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Эталон чувствительности канавочный «Спрут» модификация 12 предназначен для оценки чувствительности радиографического контроля согласно ГОСТ 7512-82 (ред. 1994 г.).

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

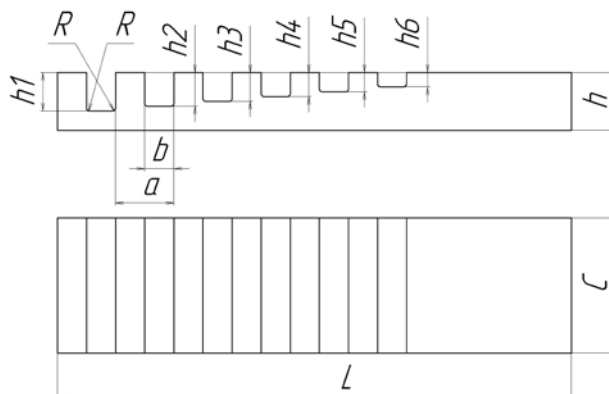


Рисунок 1 - Внешний вид эталона

Маркировка канавочного эталона чувствительности «Спрут» произведена отверстиями в соответствии с п.2.14 ГОСТ 7512-82 (ред. 1994 г.).

Таблица 1 - Технические характеристики

Параметр		Значение
	h1	$1,75^{-0,1}$
	h2	$1,5^{-0,1}$
	h3	$1,25^{-0,1}$
	h4	$1^{-0,1}$
	h5	$0,75^{-0,1}$
	h6	$0,5^{-0,1}$
Радиус скругления R, мм, не более		0,2
Шаг канавок a, мм		$4^{\pm 0,40}$
Ширина канавок b, мм		$1,5^{+0,3}$
Ширина эталона c, мм		$12^{-0,43}$
Толщина эталона h, мм		$4^{-0,12}$
Длина эталона L*, мм		$38,5^{-0,62}$
Материал		Ст3
Наличие коррозионностойкого покрытия		Да
Температура окружающего воздуха при хранении, °C		$+5 \div +40$
Температура окружающего воздуха при эксплуатации, °C		$-40 \div +45$
Относительная влажность воздуха при температуре 25 °C, %, не более		80

*Длина L соответствует способу маркировки отверстиями согласно п.2.14 ГОСТ 7512-82 (ред. 1994 г.).

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Таблица 2

Наименование	Количество
Эталон чувствительности канавочный «Спрут»	1 шт.
Паспорт	1 шт.
Чехол*	1 шт.

*Допускается упаковка до 10 шт. эталонов «Спрут» в один чехол.

4 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 4.1 Оценку чувствительности радиографического контроля с помощью канавочного эталона чувствительности следует производить согласно ГОСТ 7512-82 (ред. 1994 г.).
- 4.2 Эталон следует предохранять от механических повреждений (падений, ударов и т. п.).
- 4.3 Не допускается эксплуатация эталона, имеющего механические повреждения или коррозию.
- 4.4 Эталон чувствительности канавочный должен храниться в помещении защищенном от атмосферных осадков, воздух в помещении не должен содержать паров агрессивных газов и веществ.

5 МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ/КАЛИБРОВКИ

- 5.1 Поверка/калибровка эталона чувствительности канавочного «Спрут» производится по методике поверки РТ-МП-3540-445-2016, утвержденной ФБУ «Ростест-Москва».
- 5.2 Интервал между поверками/калибровками устанавливается потребителем в зависимости от условий и интенсивности эксплуатации, но не реже 1 раза в 5 лет.

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Эталон чувствительности канавочный «Спрут», модификация 12, зав. № _____ соответствует требованиям ГОСТ 7512-82 (ред. 1994 г.), требованиям ТУ 4276-006-96651179-2015 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____

М.П.

Подпись _____

7 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие эталона чувствительности канавочного «Спрут» требованиям ГОСТ 7512-82 (ред. 1994 г.) и ТУ 4276-006-96651179-2015 при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с даты отгрузки Покупателю.

Дата продажи _____

Подпись _____

8 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Отзывы, предложения и рекламации принимаются по адресу:

603093, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, 134, ООО «Арион».

Телефон / факс: (831) 434-93-39, (831) 278-91-53

e-mail: xrs@xrs.ru

сайт: арион.рф